

BIEWER medical

Eröffnungsanleitung für Ultra PC™ N Flowmeter

1. Das A2D Regler am Ultra PC™ N Flowmeter auf 0 % stellen. Den Gasstromregler (Gaswert) auf 0 stellen, dabei darauf achten, dass ein kleiner Widerstand überbrückt werden muss.
2. Beide Gasflüsse einstellen.
3. Die Leuchten auf 70% und Sauerstoff-Messwertumkehr auf 3 umschalten.
4. Das Gerät einblenden.
5. Sobald der Druck über den Gas mit den Leuchten ist, ist die Flussmessung in Überwachungsmodus des Ultra PC™ N Flowmeter ist.

Wir empfehlen nach jeder Behandlung die Gasflüsse inspektion und in Folge der Berechnungen des Leuchtungsmoduls zu überprüfen. Für jeden Wechsel der Gasflüsse muss dieses wiederholt werden, um die Durchflussrate mit den Gasflüssen abstimmen zu können.

Lachgassedierung

BIEWER medical

ACCUTRON
Advanced Conscious Sedative Equipment

Medizinische Gase sind nicht im Lieferumfang enthalten, wir beraten Sie gerne über den Bezug zu Sonderkonditionen bei unseren Premiumpartnern.

Mobile Stand mit analogem Flowmeter

Kundennummer: 3046

Praxis für Allgemeine Zahnheilkunde
Frau Dr. Diana Zahnert
Collenbuschstraße 16
01324 Dresden

BIEWER
medical

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Bemerkung / SN / LOT
31975EU	Accutron Ultra PC % Flowmeter 70% Lachgasbegrenzung, Baujahr 03/13	1	Hersteller 8961
26400-GM	Accutron Digital Ultra Flexmount (70% Lachgas), Baujahr		Herstellernachweis
26679 / 26798	Bag Tee / taupe / weiss / inklusive / einzeln Schraube / inklusive / einzeln	1	
42518	Kaltgerätekabel für Digital Ultra 3 m / 5 m	1	
32005 EU	Accutron mobiler, 5-füßiger Fahrständer	1	bestehend aus 2 Teilen
HFG01-2	Sicherheitsfahrgestell für O ₂ / N ₂ O Flaschen	1	bestehend aus 2 Teilen
W7250820ST	Fahrgestell aus Vierkant-Stahlrohr, Rollen 50 mm	1	
Stoff-B-01	Stoffhülle für Gasflasche 10 Liter, blau	1	
Stoff-G-01	Stoffhülle für Gasflasche 10 Liter, grau	1	
32007	Accutron Patientenschlauchsystem mit Atembeutel und Absaugung, Einmalnasenmasken inklusive autoklavierbare Nasenmasken	1 4	104008 M/2012
26255	90° Elbow	1	generell mitliefern
33025	Atembeutel wieder aufbereitbar, 3 Liter	1	
910.385	Falke-Druckminderer N ₂ O	1	420
910.382	Falke-Druckminderer O ₂		
910.355	Falke-Druckminderer O ₂ mit Flow	1	523
HS-06IO-DHGMN4	O ₂ Druckschlauch, Länge 1,80 m		
HS-06I2-DHGMN4	N ₂ O Druckschlauch, Länge 1,80 m	1	04/13
HS-09IO-DHGMN4	O ₂ Druckschlauch, Länge 2,75 m	1	04/13
HS-09I2-DHGMN4	N ₂ O Druckschlauch, Länge 2,75 m		
HS-12IO-DHGMN4	O ₂ Druckschlauch, Länge 3,65 m		
HS-12I2-DHGMN4	N ₂ O Druckschlauch, Länge 3,65 m		
HS-17IO-DHGMN4	O ₂ Druckschlauch, Länge 5,20 m		
HS-17U2-DHGMN4	N ₂ O Druckschlauch, Länge 5,20 m	1	501527930
NON9590	Nonin Pulsoxymeter Vantage 9590, Farbe Blau	1	
NON2500A	Handpulsoxymetriegerät PalmSAT2500A, Alarmfunktion		
NON PulseSense	Pulsoxymeter-Monitor PulseSense inkl. Fingerclipsensor Erwachsene, Netzteil + Akku		
33035	Sedaview™ Doppelmasken mit Duft, Pedo / Kind	2	
33037	Sedaview™ Doppelmasken mit Duft, Adult / Erwachsener	2	
33015-	Einmal-Nasenmasken mit Geruch, groß, Set 3x8 St.		
33016-	Einmal-Nasenmasken mit Geruch, mittel, Set 3x8 St.		
33017-	Einmal-Nasenmasken mit Geruch, klein, Set 3x8 St.		
Plexi150_400	Plexiglasröhre 400 mm lang		
N190020Set	Bexa TEC Notfall-Tasche Pro Large gefüllt		
Literatur	Buch „Dentale Sedierung“, Dr. F. G. Mathers		
Handbuch:	Aufbauanleitung u. Bedienungsanleitung...		
PAT2011/02	Patientenflyer mit Prospektständer - Woh		
PAT2012/01	Patientenflyer mit Prospektständer - Ang		
Poster	Angstfrei mit Lachgas		
Poster	Die erste Zahnbehandlung mit Wohlfühl		
	Foto-CD		

Datum: 6.5.13

Unterschrift

BIEWER
medical

Florian Günther
 Kundenberater und Technischer Service
 Sedierung und Notfallmanagement
 Vertriebsregion Nord-Ost

Biewer Medical Medizinprodukte
 Ein Unternehmen der Biewer Logistik GmbH


Hans-Böckler-Straße 3
 D-56070 Koblenz

Telefon/-fax +49 (0) 261 988290-60/-66

Mobil +49 (0) 171 2777 260

E-Mail florian.guenther@biewer-medical.com

Web www.biewer-medical.com






Lachgassedierung

BIEWER
medical

ACCUTRON^{inc.}

*Advanced Conscious
Sedation Equipment*

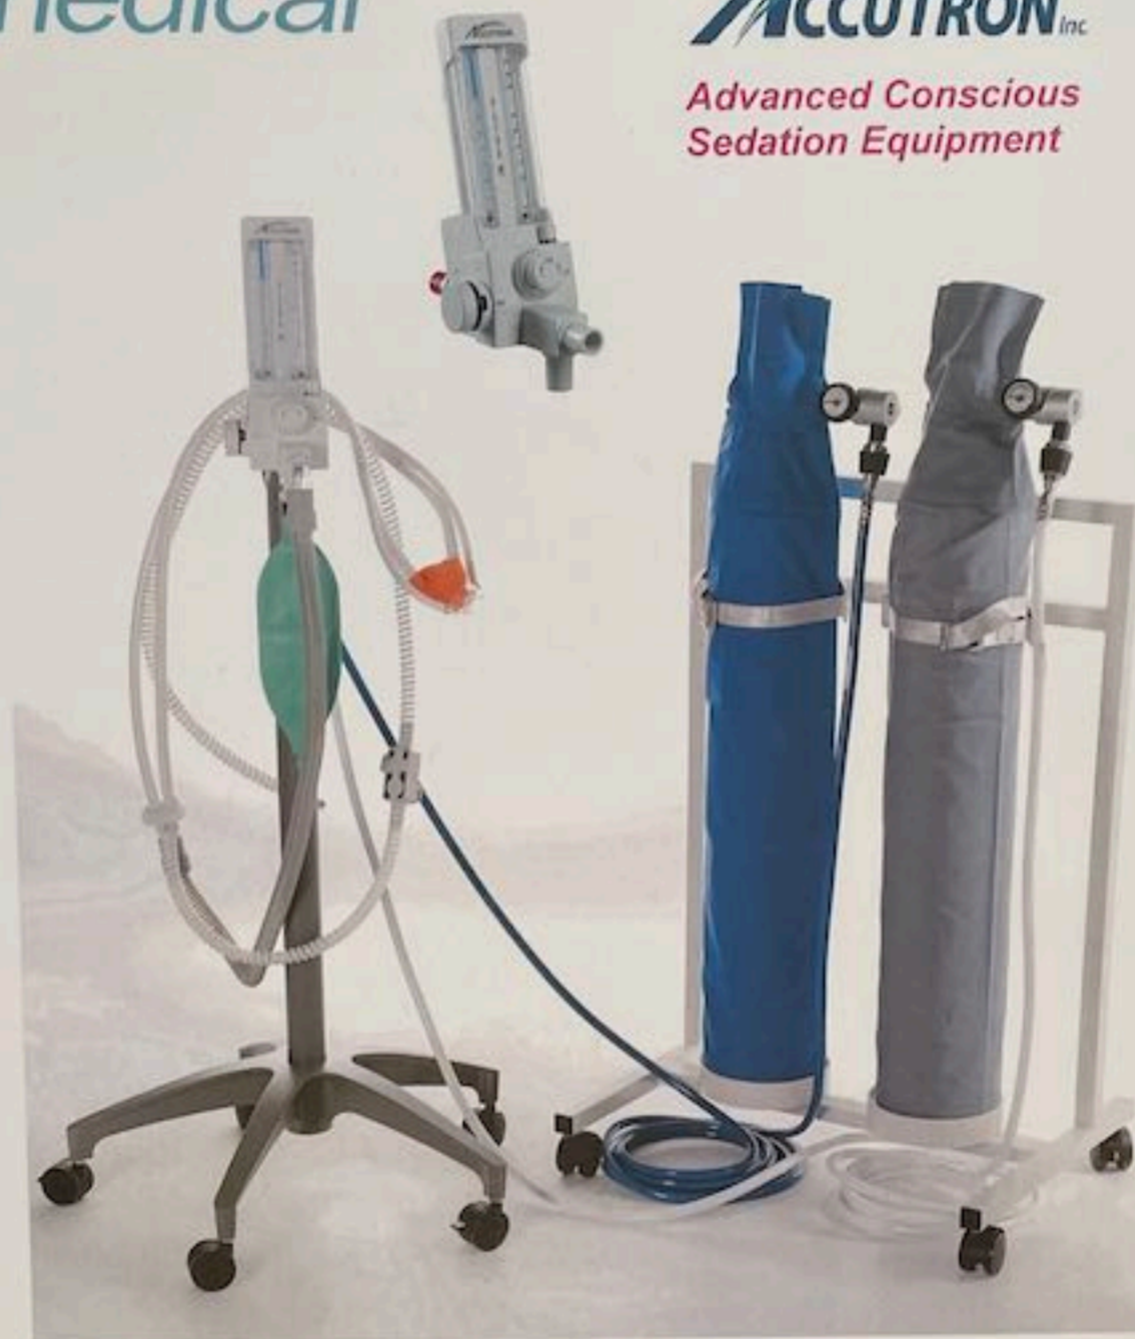

Medizinische Gase sind nicht im Lieferumfang enthalten, wir beraten Sie gerne über den Bezug zu Sonderkonditionen bei unseren Premiumpartnern.

**Mobile Stand
mit analogem Flowmeter**

ACCUTRON Inc.

7
6
5
4
3
2
1

U
L
T
R
A

P
C

Liters
Per
Minute

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

N_2O

O_2

▲ O_2 Flush

◀ Off

◀ N_2O

